


COVID-19 -kriittisten terveysteknologian tuotteiden saatavuuden yleinen kehittyminen 3.4.–5.5.2020



Sailab
MedTech Finland


YRITYKSET ARVIOIVAT ASTEIKOLLA 0–5 TUOTTEIDEN SAAVUUTTA: 0=tuotteita ei ole lainkaan saatavilla, 1=tuotteita on erittäin vähän saatavilla, 2=tuotteita on vähän saatavilla, 3=tuotteita on kohtalaisesti saatavilla, 4=tuotteita on paljon saatavilla, 5=tuotteita on erittäin paljon saatavilla.

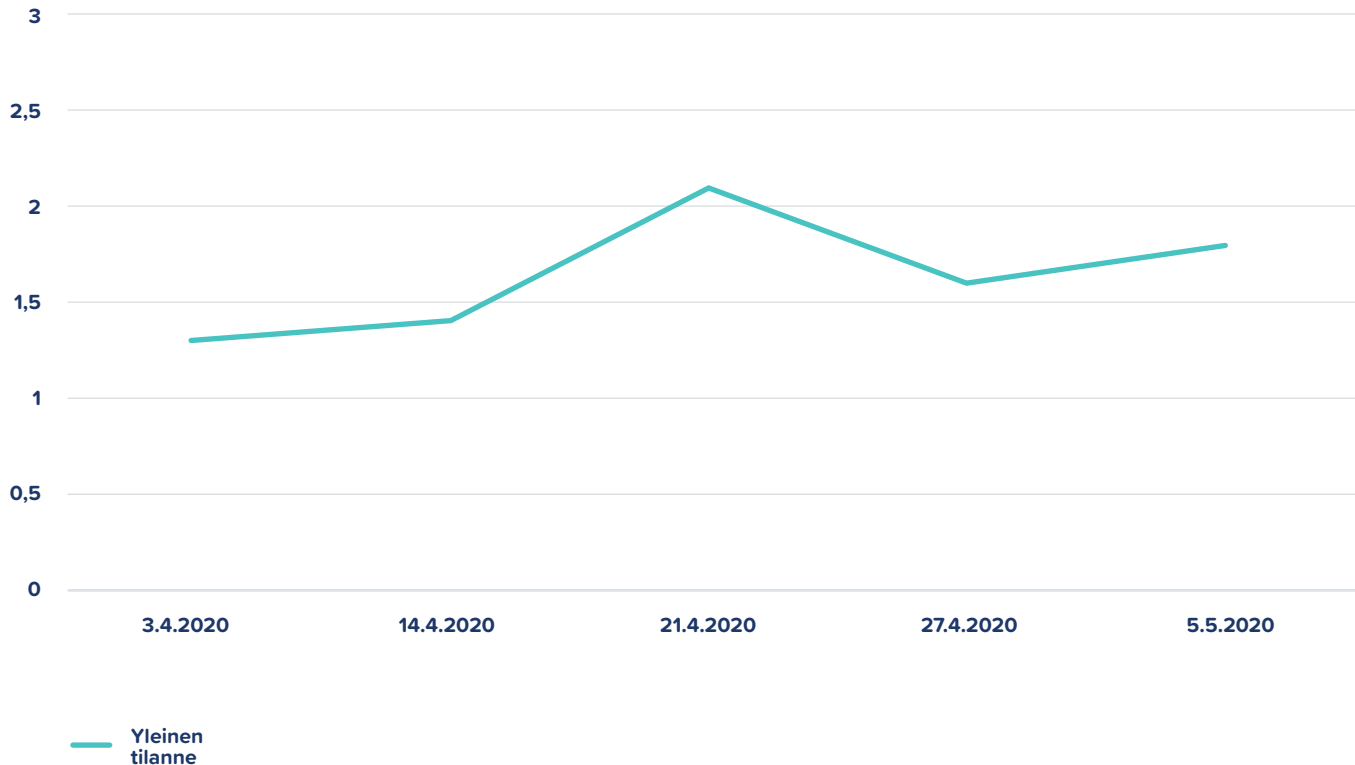

COVID-19 -kriittisten tuotteiden saatavuuden kehittyminen tuoteryhmittäin 3.4.–5.5.2020




YRITYKSET ARVIOIVAT ASTEIKOLLA 0–5 TUOTTEIDEN SAAVUUTTA: 0=tuotteita ei ole lainkaan saatavilla, 1=tuotteita on erittäin vähän saatavilla, 2=tuotteita on vähän saatavilla, 3=tuotteita on kohtalaisesti saatavilla, 4=tuotteita on paljon saatavilla, 5=tuotteita on erittäin paljon saatavilla.

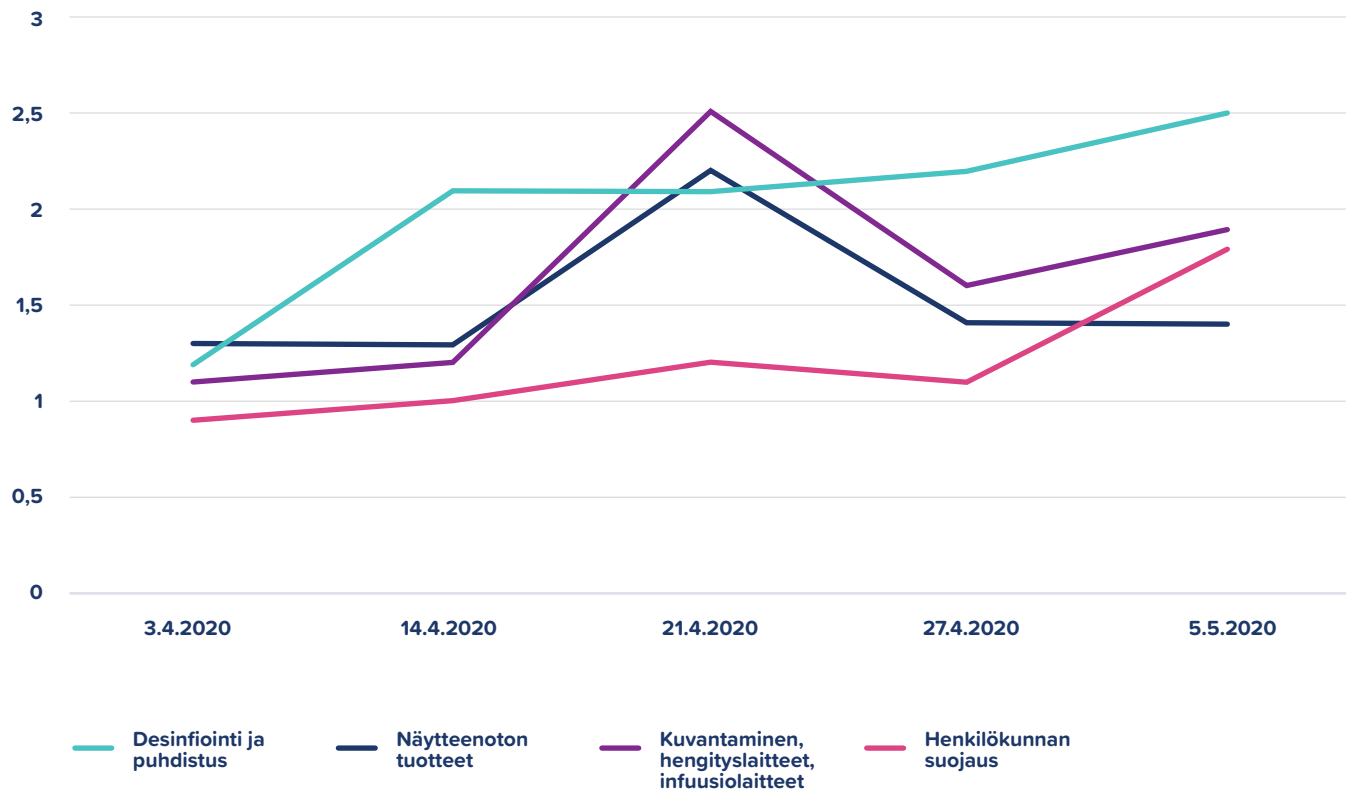

COVID-19 -kriittisten näytteenoton tarvikkeiden saatavuuden kehittyminen 3.4.–5.5.2020



YRITYKSET ARVIOIVAT ASTEIKOLLA 0–5 TUOTTEIDEN SAAVUUTTA: 0=tuotteita ei ole lainkaan saatavilla, 1=tuotteita on erittäin vähän saatavilla, 2=tuotteita on vähän saatavilla, 3=tuotteita on kohtalaisesti saatavilla, 4=tuotteita on paljon saatavilla, 5=tuotteita on erittäin paljon saatavilla.

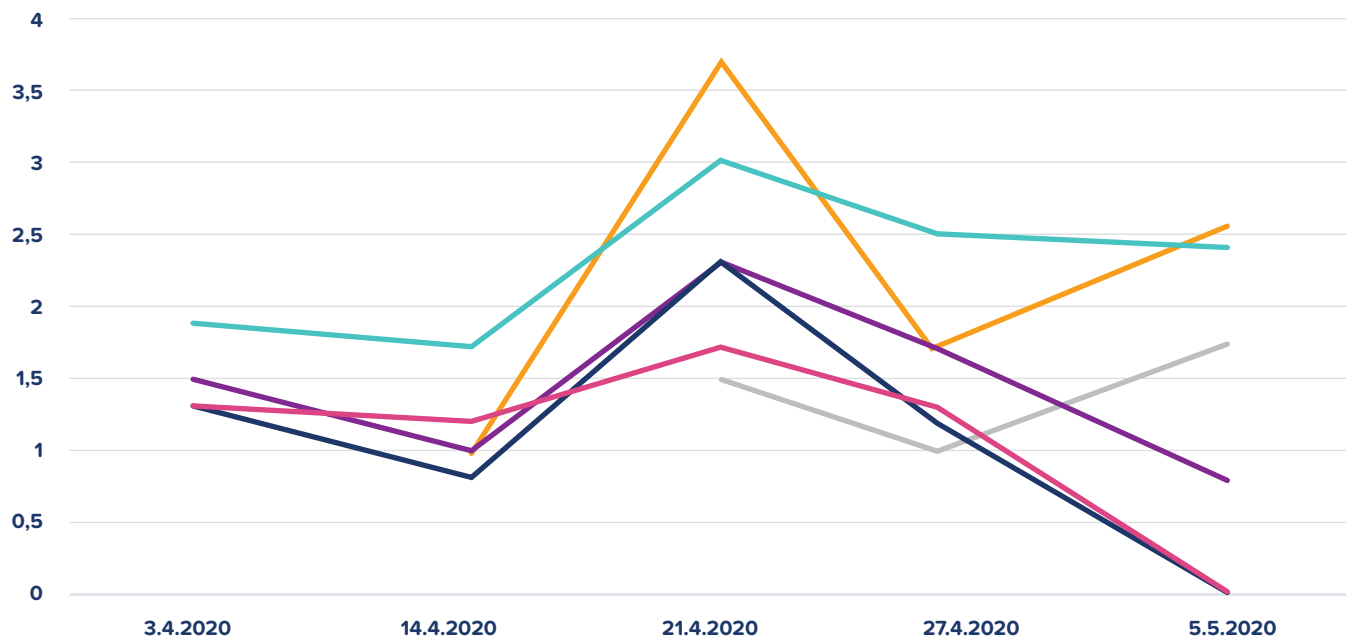

Reagenssit

Näytteenotto-
tikut

Pipetinkärjet

Kuoppalevyt


Virusten
kuljetusputket

Verinäytteen
ottamiseen
tarvittavat
välineet

COVID-19 -testien saatavuuden kehittyminen 3.4.–5.5.2020




YRITYKSET ARVIOIVAT ASTEIKOLLA 0–5 TUOTTEIDEN SAAVUUTTA: 0=tuotteita ei ole lainkaan saatavilla, 1=tuotteita on erittäin vähän saatavilla, 2=tuotteita on vähän saatavilla, 3=tuotteita on kohtalaisesti saatavilla, 4=tuotteita on paljon saatavilla, 5=tuotteita on erittäin paljon saatavilla.

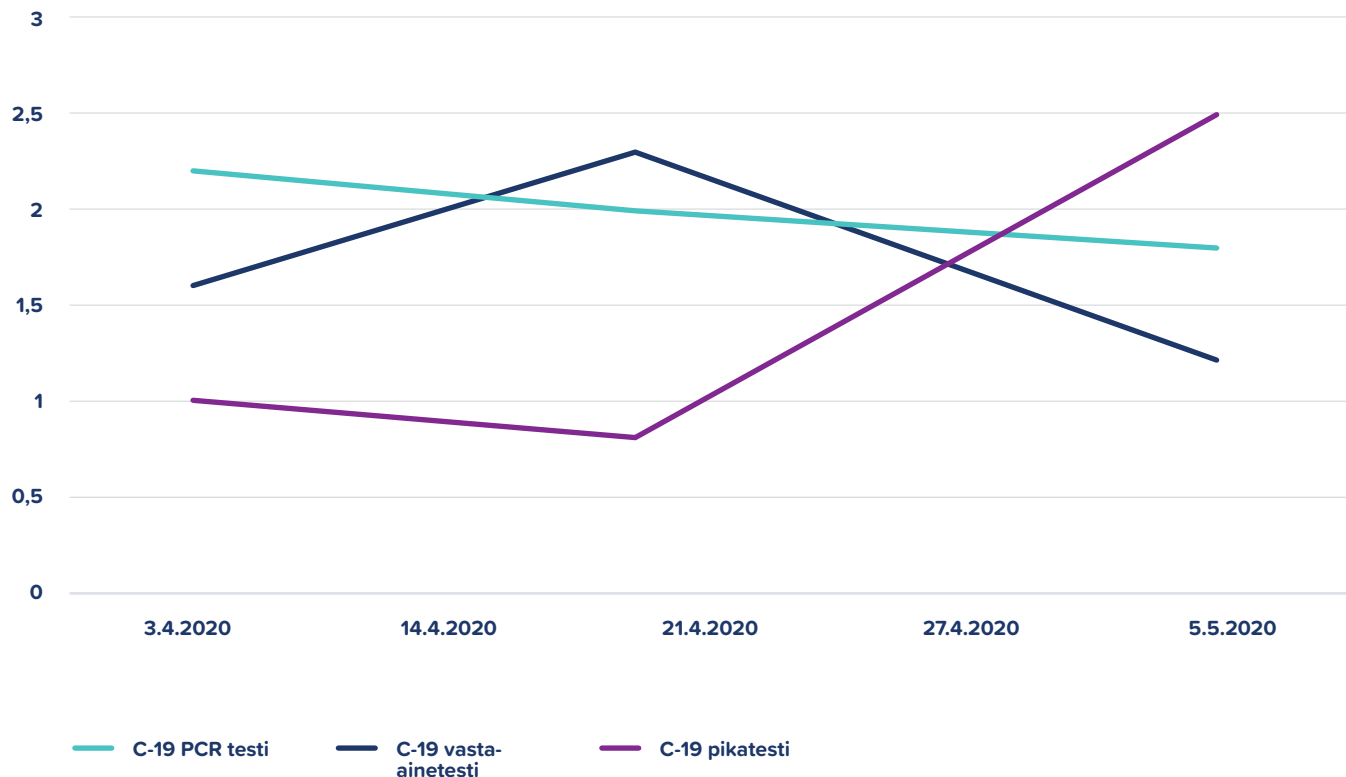

COVID-19 -kriittisten henkilöstön suojausten tarvikkeiden saatavuuden kehitys 3.4.–5.5.2020




YRITYKSET ARVIOIVAT ASTEIKOLLA 0–5 TUOTTEIDEN SAAVUUTTA: 0=tuotteita ei ole lainkaan saatavilla, 1=tuotteita on erittäin vähän saatavilla, 2=tuotteita on vähän saatavilla, 3=tuotteita on kohtalaisesti saatavilla, 4=tuotteita on paljon saatavilla, 5=tuotteita on erittäin paljon saatavilla.

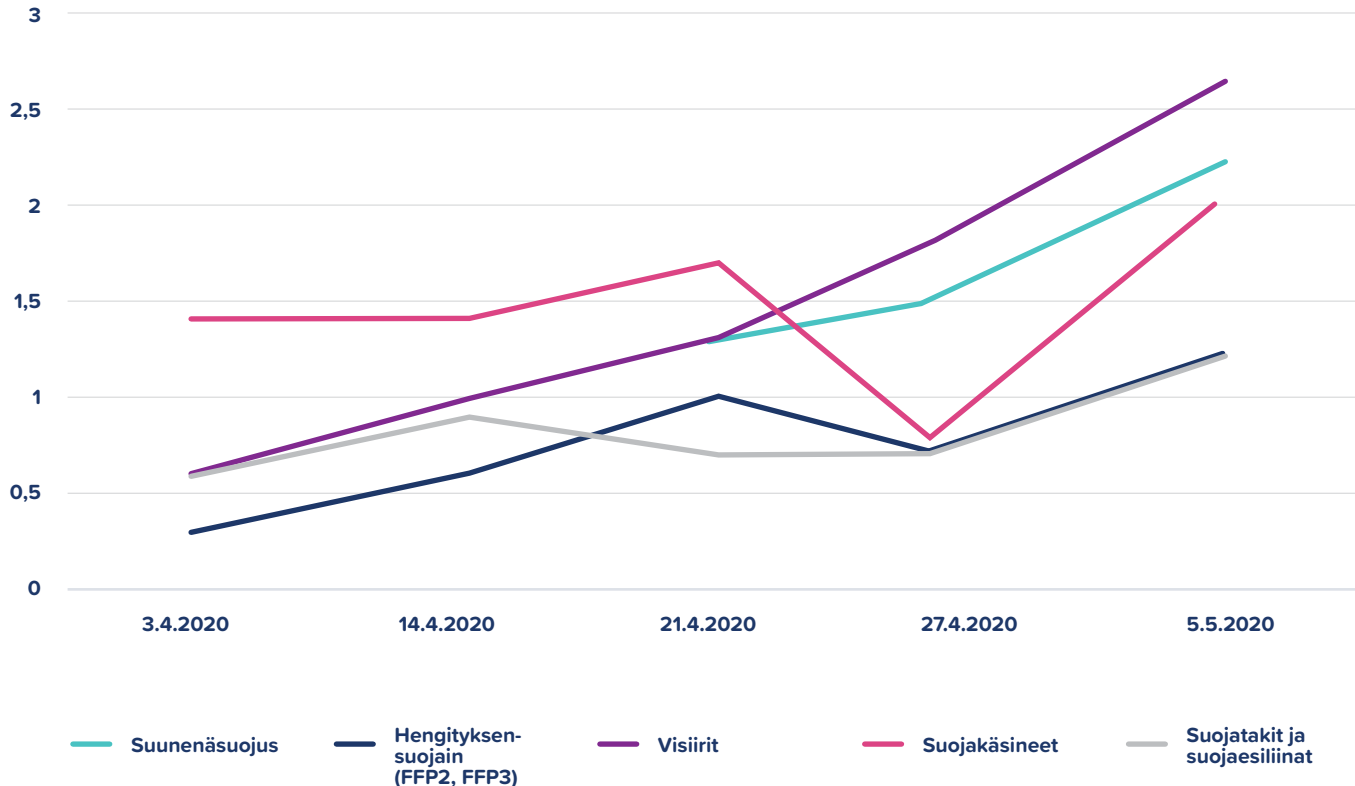

COVID-19 -kriittisten ventilaattoreiden ja tehohoidon laitteiden saatavuuden kehittyminen 3.4.–5.5.2020



YRITYKSET ARVIOIVAT ASTEIKOLLA 0–5 TUOTTEIDEN SAAVUUTTA: 0=tuotteita ei ole lainkaan saatavilla, 1=tuotteita on erittäin vähän saatavilla, 2=tuotteita on vähän saatavilla, 3=tuotteita on kohtalaisesti saatavilla, 4=tuotteita on paljon saatavilla, 5=tuotteita on erittäin paljon saatavilla.

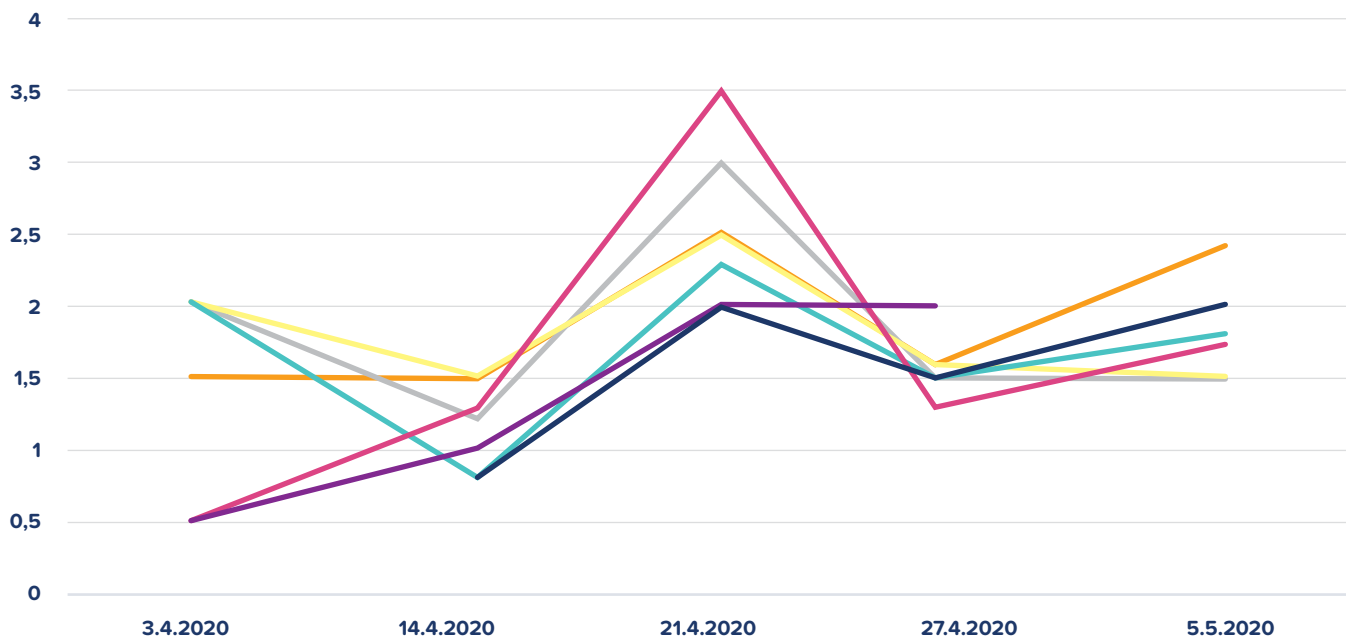

COVID-19 -kriittisten puhdistus- ja desinfiointituotteiden saatavuuden kehittyminen 3.4.–5.5.2020



YRITYKSET ARVIOIVAT ASTEIKOLLA 0–5 TUOTTEIDEN SAAVUUTTA: 0=tuotteita ei ole lainkaan saatavilla, 1=tuotteita on erittäin vähän saatavilla, 2=tuotteita on vähän saatavilla, 3=tuotteita on kohtalaisesti saatavilla, 4=tuotteita on paljon saatavilla, 5=tuotteita on erittäin paljon saatavilla.

